



Figura 1- Teste com simulador pediátrico

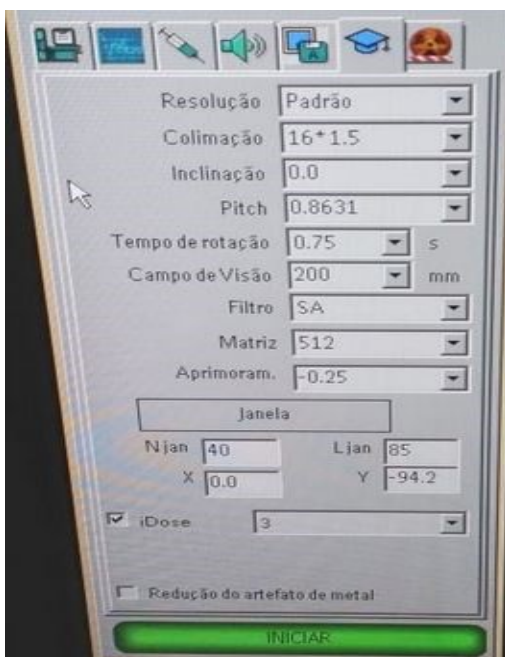


Figura 2 – Parâmetros técnicos do teste com simulador pediátrico

		<b>Uniformidade</b>	<b>Ruído</b>	<b>Exatidão</b>
Centro	Média ± Desvio	-0,061 ± 0,180	0,309 ± 0,002	-1,590 ± 0,168
	Mínimo	-0,310	0,3041	-2,782
	Máximo	0,322	0,3139	-2,179
Abaixo	Média ± Desvio	0,344 ± 0,475	0,379 ± 0,016	-1,911 ± 0,464
	Mínimo	-0,451	0,347	-2,713
	Máximo	1,201	0,404	-1,067
Acima	Média ± Desvio	0,420 ± 0,413	0,333 ± 0,007	-2,330 ± 0,322
	Mínimo	-0,475	0,319	-2,853
	Máximo	1,414	0,343	-1,717

Tabela 1 – Resultados encontrados com os testes de simulação com o fantoma